



**Sistema de calentamiento  
de pacientes  
Modelos de controlador WC0x  
Manual de servicio**

**Reenviar al departamento de ingeniería biomédica**  
*Para obtener información sobre el funcionamiento del  
sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog, consultar el  
"Manual de usuario"*

**Fabricado por:**

Augustine Temperature Management  
6581 City West Parkway  
Eden Prairie, MN 55344 USA  
TEL. 952.465.3500  
FAX 952.465.3501  
[www.hotdogwarming.com](http://www.hotdogwarming.com)

**Representante autorizado en la UE:**



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

TEL. (31) (0) 70 345-8570  
FAX (31) (0) 70 346-7299



## Contenido

Introducción .....	3
Indicaciones de uso.....	3
Contraindicaciones .....	3
Advertencias .....	3
Aviso.....	4
Precauciones .....	4
Uso y mantenimiento correctos .....	4
Leer antes de prestar servicio a equipos .....	5
Instalación inicial y montaje .....	5
Contenido.....	5
Procedimiento de montaje .....	5
Montaje del controlador Hot Dog en un soporte para suero.....	6
Descripción general del panel de control y modos operativos .....	8
Alarmas.....	9
Mantenimiento y pruebas.....	10
Comprobación de la función del indicador luminoso.....	10
Comprobaciones de seguridad eléctrica y pruebas funcionales .....	10
Limpieza .....	13
Limpieza—General .....	13
Limpieza—Controlador.....	13
Limpieza—Dispositivos de calentamiento .....	14
Solución de problemas/códigos de error.....	15
Servicio de soporte técnico y atención al cliente .....	16
Definición de símbolos .....	17
Números de referencia de accesorios.....	17
Especificaciones.....	18
Compatibilidad electromagnética (EMC).....	20

## INTRODUCCIÓN

El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog consta del controlador Hot Dog, dispositivos de calentamiento reutilizables (por ejemplo, mantas de calentamiento) y accesorios. Este manual incluye instrucciones de mantenimiento y especificaciones de los modelos de controlador Hot Dog WC0X y V0XX. Para obtener información sobre los dispositivos de calentamiento y los accesorios Hot Dog, consultar el “Manual de usuario” suministrado con cada dispositivo y accesorio.

El controlador Hot Dog se ha diseñado para ayudar a mantener la temperatura normal en pacientes antes, durante y después de procedimientos quirúrgicos y para ayudar a prevenir la hipotermia accidental. El sistema está alimentado y controlado por una unidad de control electrónico. Los dispositivos de calentamiento (por ejemplo, mantas) están alimentados con baja tensión, lo que garantiza la seguridad de pacientes y operadores. Las temperaturas de calentamiento se controlan automáticamente según niveles seleccionados por el usuario y los apagados de seguridad por sobrecalentamiento están integrados en el controlador, así como en cada dispositivo de calentamiento.

El controlador Hot Dog se puede colocar sobre una superficie plana, montado en un soporte para suero o suspendido del raíl de la mesa de quirófano o camilla usando ganchos opcionales. El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog puede hacerse funcionar constantemente para mantener calor uniforme encima del paciente. El usuario tiene la responsabilidad de determinar si es adecuado el calentamiento para cada uno de los pacientes. El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog no debe utilizarse cuando las consideraciones clínicas indican que no es aconsejable dar calor al paciente.

## Indicaciones de uso

El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog está diseñado para prevenir o tratar la hipotermia y para hacer entrar en calor a los pacientes. El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog debe utilizarse en circunstancias en las que los pacientes no pueden mantener la temperatura normal. El uso previsto principalmente del sistema es en hospitales y centros quirúrgicos, incluyendo entre otros quirófanos, salas de recuperación y de emergencias, y en plantas médicas y quirúrgicas.

## Contraindicaciones

- NO APLIQUE calor a tejidos isquémicos o no perfundidos, se pueden causar quemaduras. Ejemplos pueden ser tejidos distales al llamado de la aorta, o cuando se usen medicamentos vasoconstrictores que lleven a una vasoconstricción severa y prolongada.
- NO dar calor a pacientes que reciben medicación transdérmica; puede aumentar el suministro transdérmico de fármacos.

## Advertencias

- **ADVERTENCIA:** Para evitar riesgo de descarga eléctrica este equipo deberá únicamente ser conectado a cableado de suministro que tengan conexión de protección a tierra.
- **PELIGRO DE EXPLOSIÓN – NO** usar el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog en presencia de anestésicos inflamables o entornos muy enriquecidos en oxígeno como cámaras hiperbáricas, tiendas de oxígeno, etc.

- **Inspeccionar los componentes Hot Dog antes de usarlos** por si hay signos de daños o excesivo desgaste como cortes, agujeros o conexiones eléctricas flojas. Si hay signos evidentes de desgaste, no usar el producto hasta que lo inspeccione el personal técnico.
- **NO** seguir usando el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog si el indicador de sobrecalentamiento o la alarma continúan sonando después de restablecer el sistema. Consultar la sección “Alarma” de este manual para obtener más información.

### **Manta de calentamiento**

- **NO** colocar mantas de calentamiento Hot Dog debajo del paciente. El colchón calentador y las sábanas desechables son los únicos accesorios diseñados para usarlos debajo del paciente.

### **Accesorios y otros equipos**

- Los accesorios y cables que no sean los especificados en el manual de usuario pueden causar un aumento de emisiones o una disminución de inmunidad del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog.
- El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog no debe utilizarse junto a otros equipos o apilado con ellos. Si es necesario un uso adyacente o apilado, observar atentamente el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog para verificar que funciona normalmente en esas configuraciones no recomendadas.

### **Aviso**

La legislación federal de EE. UU. restringe la venta de este producto a profesionales sanitarios homologados o por prescripción facultativa.

### **Precauciones**

- Usar bajo la supervisión directa de un médico.
- Monitorizar regularmente los signos vitales del paciente durante el calentamiento según el protocolo institucional. Si alguno de los signos vitales es inestable, notificarlo al médico.
- Hay que proceder con cuidado cuando se utilicen varios métodos para hacer entrar en calor.
- El riesgo de irritación cutánea causada por acumulación de soluciones de preparación quirúrgica debajo del paciente puede aumentar con el calentamiento. Se deben seguir las instrucciones de uso para soluciones de preparación quirúrgica.

### **Uso y mantenimiento correctos**

- **NO SEGUIR USO** de manta de calentamiento después de fecha de expiración descrito. No abrir el controlador Hot Dog. No hay piezas reparables por el usuario. Si se requiere servicio técnico hay que ponerse en contacto con el soporte técnico (ver **página 16**). El fabricante no asume ninguna responsabilidad de la fiabilidad, rendimiento o seguridad del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog en los siguientes casos:
  - El controlador es desmontado o reparado por una persona no autorizada.
  - Los componentes del sistema de calentamiento de pacientes se utilizan de forma distinta a la descrita en los manuales de usuario.
  - El controlador está instalado en un entorno que no cumple los requisitos eléctricos y de toma de tierra adecuados.

- El controlador está conectado a tierra y no debe colocarse en una mesa sin conexión a tierra cuyo uso previsto sea como una unidad electro quirúrgica o con dispositivos equivalentes.

## Leer antes de prestar servicio a equipos

La reparación, el mantenimiento preventivo, las pruebas de seguridad y la prestación de servicio del sistema de calentamiento de pacientes requieren la capacidad de los técnicos cualificados de servicio de equipos sanitarios que estén familiarizados con las buenas prácticas de reparación de productos sanitarios. No abrir el controlador Hot Dog. No hay piezas reparables por el usuario. Si se requiere servicio técnico hay que ponerse en contacto con el soporte técnico (ver **página 16**). Realizar todas las actividades de mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de este manual de servicio.

## INSTALACIÓN INICIAL Y MONTAJE

### Contenido


Los siguientes componentes están incluidos en la caja del controlador Hot Dog:

- 1—Controlador Hot Dog (modelo WC0X o V0XX)
- 1—Adaptador de soporte para suero y componentes de montaje
- 1—Cable de alimentación eléctrica
- 1—CD que contiene manual del usuario y manual de servicio
- 1—Cable de manta de calentamiento Hot Dog (P/N A101)

Los accesorios Hot Dog reutilizables (por ejemplo, mantas de calentamiento, colchones calentadores, cables de conexión, ganchos para raíl de mesa de quirófano y camilla con componentes de montaje) y las sábanas desechables Hot Dog se venden por separado.

### Procedimiento de montaje

1. Sacar todos los objetos de la caja y desechar el embalaje según el protocolo institucional.
2. Aflojar y quitar los dos tornillos de retención de cables y el retenedor de cables (ver **Figura 1**; el retenedor de cables se encuentra en la parte trasera del controlador).
3. Insertar firmemente el cable de alimentación eléctrica en el receptáculo de la parte trasera del controlador.
4. Colocar el retenedor de cables sobre el sujetacables del cable de alimentación eléctrica; volver a colocar ambos tornillos y apretar para ajustar el retenedor de cables (ver **Figura 1**).

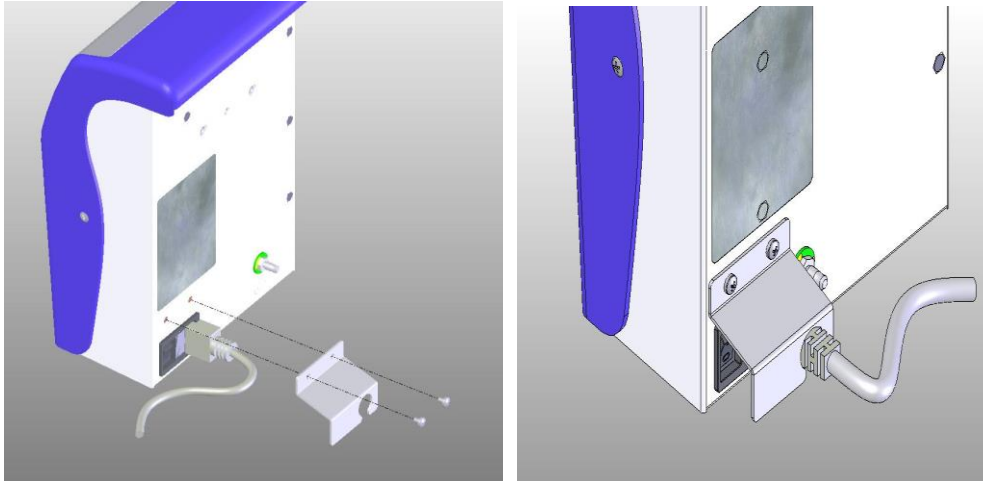
**Figura 1: Conjunto del retenedor de cables**

### Montaje del controlador Hot Dog en un soporte para suero

Para montar el controlador Hot Dog en un soporte para suero, colocar el adaptador de soporte para suero del controlador alrededor del soporte y gire el mango del clamp en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté apretado firmemente (**Figura 2**). Para quitar el controlador del soporte para suero, girar el mango de la pinza en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se libere la unidad.


#### **Aviso**

Para evitar que el soporte para suero se vuelque, el controlador debe fijarse a una altura que proporcione estabilidad. Es recomendable utilizar un soporte para suero con un radio mínimo entre ejes de 35,6 cm (14 pulg.) y montar el controlador a una altura que no supere los 112 cm (44 pulg.) desde el suelo. Si no se monta correctamente el controlador puede causar el vuelco del soporte para suero, traumatismo en el sitio del catéter y lesiones al paciente.

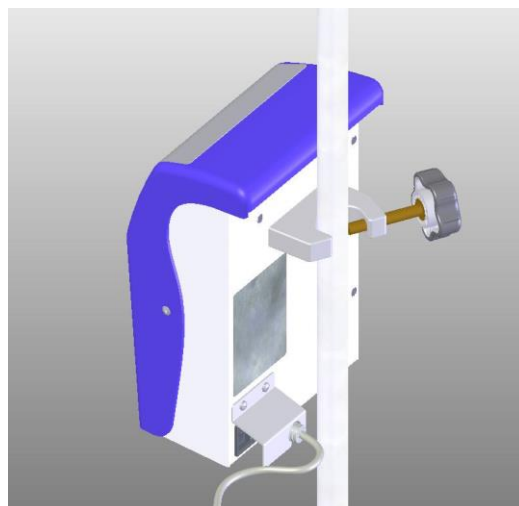**Figura 2: Controlador Hot Dog montado en un soporte para suero**

El controlador también se puede suspender del raíl de mesa de quirófano o la camilla usando ganchos opcionales (**Figura 3**).

**Figura 3: Ganchos opcionales para raíl de mesa de quirófano o camilla**

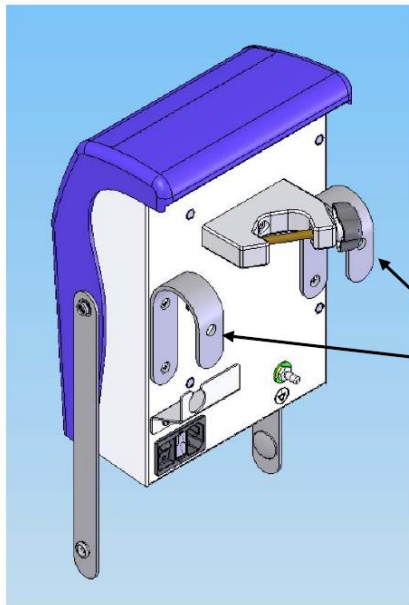




El controlador se puede suspender del raíl de mesa de quirófano o la camilla usando estos ganchos opcionales

(Nota: La ubicación de los ganchos puede variar según el modelo)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL Y MODOS OPERATIVOS

Figura 4: Controles de los modelos Hot Dog WC0X y V0XX

- A -Luz de encendido de la alimentación eléctrica
- B -Luz de temperatura en el intervalo
- C -Botones de ajuste de temperatura
- D -Luces de configuración de temperatura (3)
- E -Luz de alarma de puerto A
- F -Luz de alarma de puerto B
- G -Puerto A (manta de calentamiento)
- H -Puerto B (auxiliar)
- I - Número de serie
- J - Pinza de soporte de suero
- K -Módulo de entrada de energía
  - Cuadro de fusibles
  - Interruptor de alimentación eléctrica
  - Enchufe
- L - Retenedor de cable

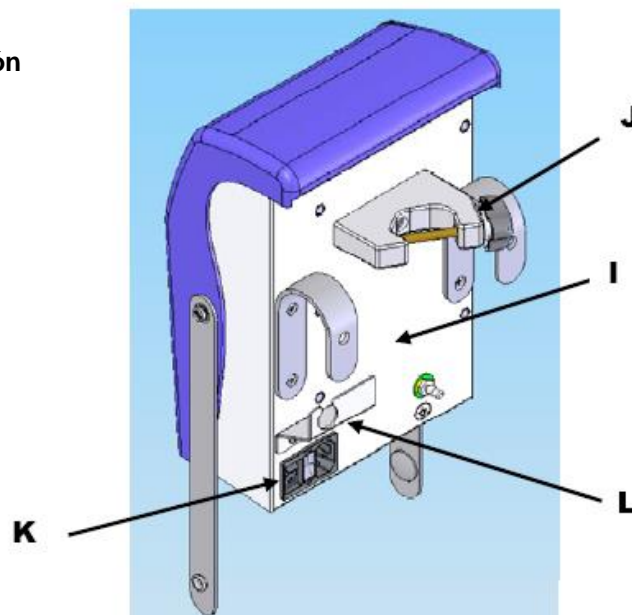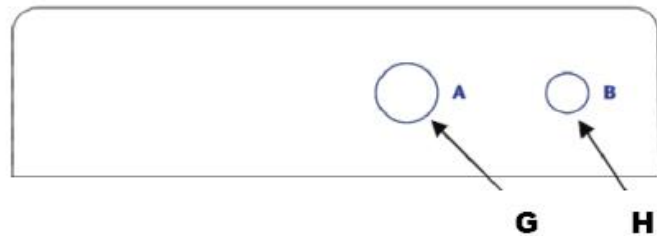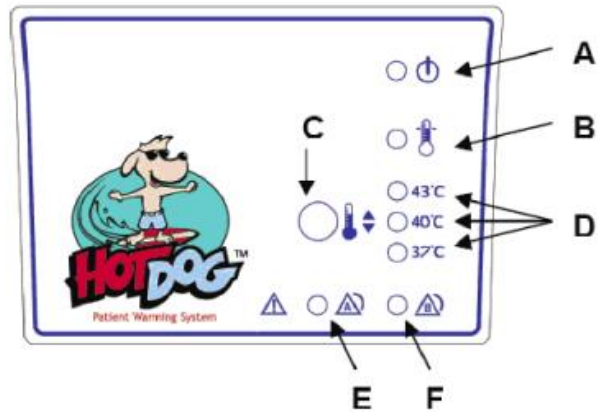



***Interruptor de alimentación eléctrica / Indicador de encendido***

Cuando el controlador Hot Dog está conectado en una toma eléctrica y el interruptor de alimentación de la parte trasera del controlador está encendido, todos los indicadores se iluminarán brevemente y el controlador emitirá un pitido. La luz de encendido de la alimentación eléctrica se iluminará y el controlador permanecerá inactivo hasta que se conecte un dispositivo de calentamiento. Cuando la unidad está encendida e inactiva (es decir, no hay luces de valor de temperatura iluminadas), no se suministra energía al dispositivo de calentamiento y no se indican estados de alarma.

***Botón de ajuste de temperatura / Luces de configuración de temperatura***

Pulsar el botón de ajuste de temperatura hasta que esté seleccionada la temperatura alta (43 °C), media (40 °C) o baja (37 °C) deseada, como indica la luz iluminada de configuración de temperatura. La temperatura de calentamiento designada se alcanzará en 5 minutos.

***Luz de temperatura en el intervalo***

La luz verde de temperatura en el intervalo se iluminará cuando la temperatura de la manta de calentamiento esté a  $\pm 1$  °C del valor de temperatura seleccionado.

***Puerto A***

El puerto A solo debe utilizarse para la conexión de una manta de calentamiento Hot Dog. Cuando una manta de calentamiento se conecta en el controlador, un pitido audible indica que los sensores de control y sobrecalentamiento (dispositivo de seguridad) están presentes, funcionan correctamente y el dispositivo está listo para usarlo.

***Puerto B***

El puerto B es una salida de 48V para futuros accesorios Hot Dog aprobados.

**Alarmas*****Alarma de puerto A***

Si el sensor de alarma de temperatura excede en un grado sobre el punto de ajuste o existe otra condición de falla, sonará una alarma audible y la Luz de Alarma del puerto en cuestión se encenderá con color amarillo. El controlador automáticamente desconectará el dispositivo de calentamiento. Si la luz de alarma permanece encendida y el sonido de alarma continúa, desconecte el dispositivo de calentamiento del controlador para apagar la alarma. Si la alarma del Controlador permanece activada después de reestablecerlo, deje de usarlo y envíe el Controlador a ingeniería biomédica para su evaluación o haga contacto con soporte técnico.

Acuda a la sección de códigos de error y solución de problemas sobre la información específica de los códigos de error.

- Si se activa la alarma al conectar una manta de calentamiento al controlador, desconecte la manta y sustitúyala por otra manta de calentamiento.

***Alarma de puerto B***

Si el accesorio conectado al puerto B supera el límite de corriente preestablecido, suena una alarma audible y la luz de alarma del puerto B se ilumina en amarillo. Se suprime la alimentación del puerto. Desconectar el accesorio del puerto B para restablecer la alarma.

- Si se activa la alarma del puerto B al conectar un accesorio al controlador, desconectar el accesorio y sustituirlo por otro accesorio.
- Si se activa la alarma del puerto B durante el uso y la luz de alarma del puerto B se queda iluminada, desconectar el accesorio y sustituirlo por otro accesorio.

### **Temporizador de tiempo agotado**

- El tiempo para alcanzar la temperatura del punto de ajuste seleccionado desde 23°C +/- 2°C es menor a 10 minutos. Si el dispositivo de calentamiento no alcanza la temperatura establecida en 10 minutos, el controlador emitirá una alarma.

**Nota:** Si el controlador se deja encendido más de 6 horas, la alimentación al calentador se apaga automáticamente. Eso está indicado por 3 pitidos audibles tras los cuales el LED de alarma parpadeará continuamente. Pulsar una vez el botón de selección de temperatura suprimirá esta condición de alarma y se reanudará la alimentación del calentador.

## **MANTEMIENTO Y PRUEBAS**

### **Comprobación de la función del indicador luminoso**

#### **Frecuencia**

La prueba debe completarse tras el registro inicial del equipo y una vez cada 12 meses (o con más frecuencia si lo exigen las directrices del hospital).

#### **Método**

1. Insertar el enchufe del controlador Hot Dog en una toma eléctrica conectada a tierra de calidad hospitalaria y confirmar que NO haya cables ni dispositivos conectados a ninguno de los puertos.
2. Poner el interruptor de alimentación eléctrica en posición de encendido (ON) y observar la siguiente secuencia correcta de inicio:
  - a. Todas las luces se iluminan brevemente.
  - b. La luz de encendido de alimentación eléctrica permanece iluminada mientras que las demás luces se iluminan una a una por el siguiente orden:
    1. Temperatura en el intervalo
    2. Alarma A
    3. Alarma B
    4. 43°
    5. 40°
    6. 37°
  - c. Todas las luces se iluminarán simultáneamente y entonces la unidad emitirá un tono audible.
  - d. Cuando la secuencia se completa, solo queda iluminada la luz de encendido de alimentación eléctrica.
3. Si esta secuencia cambia o es incompleta, hay que ponerse en contacto con el soporte técnico (ver **página 16**).

### **Comprobaciones de seguridad eléctrica y pruebas funcionales**

#### **Frecuencia**

Estas pruebas deben completarse una vez cada 12 meses (o con más frecuencia si lo exigen las directrices del hospital).

**Útiles/equipo**

- Banco de ensayo (Test fixture) (Ref. A115)
- Cable de manta de calentamiento (Ref. HDPC1, A101 o A102)
- Comprobador de continuidad de toma de tierra
- Comprobador de corriente de fugas
- Termopar y termómetro calibrado de reacción rápida (opcional)
- Manta de calentamiento Hot Dog (opcional)

**Método**

1. Realizar la “Comprobación de la función del indicador luminoso” tal y como se describe en la página anterior.
2. Realizar las siguientes pruebas en el controlador según el protocolo institucional estándar.
  - A. Continuidad de toma de tierra
  - B. Conectar una manta de calentamiento al controlador y comprobar la corriente de fuga para asegurarse de que la corriente de fuga máxima no excede los requisitos de la **Tabla 1**.

**Nota: El botón equipotencial de la parte trasera del controlador Hot Dog se puede utilizar como un punto de toma de tierra para esas pruebas.**

<b>Tabla 1: Máxima corriente de fugas permitida</b>		
<b>Polaridad</b>	<b>Condición</b>	<b>Corriente (mA)</b>
Normal / invertida	Normal	0,1
	Tierra abierto	0,5
	Tierra neutro	0,5
	Tierra abierto y tierra neutro	0,5

3. Realizar las “Pruebas funcionales” descritas en las siguientes páginas.

### **Método de pruebas funcionales del controlador**

Usar un banco de ensayo de temperaturas (Ref. A115) y consulte las instrucciones incluidas para su uso, o una manta de calentamiento para seguir los pasos descritos a continuación. El banco de ensayo simula una manta de calentamiento funcionando a 43 °C. Si se observa algún error durante cualquiera de estos pasos, llamar a atención al cliente.

### **Pruebas funcionales de manta y controlador**

Usar una manta de calentamiento Hot Dog para seguir los pasos descritos a continuación. Si se observa algún error durante cualquiera de estos pasos, repetir la comprobación usando una manta de calentamiento distinta. Si el error se observa con la segunda manta de calentamiento, ponerse en contacto con el soporte técnico (ver **página 16**).

1. Adherir con cinta un sensor de temperatura calibrado de reacción rápida a la superficie de la manta de calentamiento que está de cara al paciente, directamente sobre la marca de sensor.
2. Doblar hacia atrás la manta de calentamiento sobre sí misma (lado negro hacia lado negro) de manera que el termopar esté dentro de la zona plegada. Colocar entre 750 y 1000 g de peso (como un libro pequeño) sobre la ubicación del sensor para asegurarse de que la almohadilla se queda plegada y de que existe buen contacto entre el sensor y la manta plegada.
3. **Figura 5**

**Figura 5: Configuración de pruebas de manta de calentamiento**



4. Poner el interruptor de alimentación eléctrica del controlador en posición de encendido. Conectar el cable de la manta o el colchón de calentamiento al controlador. *El controlador emitirá un tono audible cuando se conecte la manta o el colchón.*
5. Establecer el controlador Hot Dog en la temperatura que se debe verificar. Si se comprueban todos los puntos establecidos, comenzar con el valor bajo de temperatura.
6. Después de que el dispositivo de calentamiento alcance el punto establecido (se indica cuando la lectura de punto establecido ya no parpadea), dejar que la temperatura se estabilice durante 10 minutos más. *NOTA: Es normal observar que se sobrepasa la temperatura al comprobar de esta forma.*
7. Después de 10 minutos, la lectura en el termómetro debe estar en el valor de  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  de la temperatura del punto establecido. Cuando se mide la temperatura, debe tenerse en cuenta la precisión y tolerancia del termómetro. Eso dependerá del tipo de medidor utilizado y puede oscilar entre  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  y  $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ . La tolerancia de medición del medidor se debe agregar a  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$  de tolerancia del sistema Hot Dog para determinar

los criterios superado/no superado de esta prueba. Por ejemplo: Si el controlador se establece en 41°C y la medición se hace con un termómetro que tiene una tolerancia de medición de +/- 1,0°C, el intervalo aceptable de temperaturas medidas será de 39 a 43°C (es decir, 41 +/- 2°C).

8. Repetir los pasos 4-6 para el siguiente valor de temperatura, si es necesario.

## **LIMPIEZA**

### **Limpieza—General**

#### **Advertencias**

- NO usar un paño húmedo empapado NI sumergir componentes Hot Dog en líquido. La humedad dañará los componentes y puede provocar lesiones térmicas.

#### **Precauciones**

- NO usar disolventes duros puros (por ejemplo, MEC, acetona, etc.) para limpiar componentes Hot Dog. Los disolventes pueden dañar las piezas de plástico, el etiquetado y el acabado del producto.
- NO usar desinfectantes de alto nivel (por ejemplo, glutaraldehído, ácido paracético o soluciones basadas en peróxido de hidrógeno). Los centros de control de enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan que no se usen desinfectantes de alto nivel para limpiar superficies del entorno que pueden entrar en contacto con el paciente puesto que los productos químicos son muy tóxicos.
- NO rociar soluciones de limpieza en los conectores eléctricos.

#### **Limpiadores recomendados**

Los desinfectantes con base de alcohol son más fáciles de usar porque actúan deprisa y se pueden rociar o pasar con un paño. La siguiente lista de limpiadores con base de alcohol se facilita solo como referencia y no supone un respaldo a los fabricantes ni a sus productos de limpieza: Ecolab (Incidin Liquid, Incides N, Incidin Foam, Incidin Sun, Mikro-Bak III), Merz (Pursept-A Xpress, Pursept Foam, Mucocit-A Economy) y Lysoform (Aerodesin 2000, Lysoform Spray).

Otros limpiadores que se han ensayado y son compatibles con las superficies externas de componentes Hot Dog son hipoclorito de sodio (lejía diluida), detergente fenólico germicida y detergente de amonio cuaternario.

Limpiadores con contenido de yodo pueden causar decoloración en la superficie del material y por lo tanto NO son recomendados para limpieza rutinaria. Soluciones basadas en peróxido de hidrógeno NO se recomiendan porque los vapores degradan las telas conductoras de los calentadores.

### **Limpieza—Controlador**

#### **Frecuencia**

Según sea necesario

#### **Útiles/equipo**

- Esponja o paño suave
- Detergente suave o rociador antimicrobiano
- Paño suave seco

**Método**

1. Desconectar el controlador de la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Pasar una esponja o un paño suave humedecido sobre la unidad; evitar que entren líquidos en las aberturas.
3. Secar con otro paño suave.

**Limpieza—Dispositivos de calentamiento****Frecuencia**

Limpiar entre usos de pacientes y cuando esté sucio el dispositivo de calentamiento.

**Método**

Limpiar los dispositivos de calentamiento siguiendo los protocolos para productos sanitarios no críticos que pueden entrar en contacto con piel intacta. Por ejemplo, son productos similares los brazaletes de presión arterial, las fundas de mesas de exploración, las almohadillas de mesas de quirófanos y los soportes quirúrgicos. **Los pasos de limpieza se describen en el manual de usuario que se proporciona con el dispositivo de calentamiento.** Tener en cuenta que las instrucciones de limpieza son recomendaciones generales y no sustituyen los protocolos de limpieza específicos del hospital.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/CÓDIGOS DE ERROR

Modo de alarma	Descripción
Sobrecalentamiento primario	<p>Cuando la temperatura supera en un grado el valor nominal (incluyendo tolerancias), se inician alarmas audibles y visuales y se suprime la alimentación de la salida. La alarma se restablecerá cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura se encuentre entre límites aceptables (<math>\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• El cable que conecta la manta de calentamiento al controlador está desconectado</li> <li>• Se haya suprimido la energía de la red eléctrica</li> </ul>
Sobrecalentamiento secundario	<p>Cuando la temperatura supera <math>46^{\circ}\text{C}</math>, se inician alarmas audibles y visuales. La alarma se restablecerá cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable que conecta la manta de calentamiento al controlador está desconectado</li> <li>• Se haya suprimido la energía de la red eléctrica</li> </ul>
Sobrecarga eléctrica	<p>Cuando el consumo de corriente supera un nivel predeterminado, se inician alarmas audibles y visuales. La alarma se restablecerá cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se haya suprimido la energía de la red eléctrica</li> </ul>
No se pudo alcanzar temperatura	<p>Cuando el sistema no alcanza <math>43^{\circ}\text{C}</math> en 10 minutos, se inician alarmas audibles y visuales. La alarma se restablecerá cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable que conecta la manta de calentamiento al controlador está desconectado</li> <li>• Se haya suprimido la energía de la red eléctrica</li> </ul>
Error del sensor	<p>Cuando el sensor está abierto o en cortocircuito, se inician alarmas audibles y visuales y se suprime la alimentación de la salida. Si ambos sensores están abiertos o en cortocircuito, no se inician alarmas, se suprime la alimentación de salida y el conmutador del selector de temperatura se queda inactivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustituir la manta de calentamiento</li> </ul>
Detección de pliegue	<p>Si la manta calentadora se pliega sobre sí misma de modo que se produce una condición de sobrecalentamiento, se inician alarmas audibles y visuales. La alarma se restablecerá cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura de la zona plegada ha bajado y</li> <li>• El cable que conecta la manta de calentamiento al controlador está desconectado <u>o</u></li> <li>• Se haya suprimido la energía de la red eléctrica</li> </ul>
Temporizador de tiempo agotado	<p>Si el dispositivo de calentamiento no alcanza la temperatura establecida en 10 minutos, el controlador emitirá una alarma.</p>
Temporizador de tiempo agotado de 6 horas	<p>Si un dispositivo de calentamiento se deja funcionando 6 horas sin cambiar el valor establecido, se suprimirá la alimentación, sonarán tres pitidos cortos audibles y los indicadores de alarma parpadearán continuamente. Al pulsar el botón de selección de temperatura se desactivará la alarma y se reiniciará el funcionamiento normal.</p>
































## **SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE**

Tenga a mano el número de serie de su controlador Hot Dog cuando llame al servicio de soporte técnico. El número de serie se encuentra en la parte trasera del controlador. Si es necesario devolver el controlador por servicio o reparación, póngase en contacto con su proveedor local o representante de ventas.

Augustine Temperature Management  
6581 City West Parkway  
Eden Prairie, MN 55344 USA  
TEL. 952.465.3500  
FAX 952.465.3501  
[www.hotdogwarming.com](http://www.hotdogwarming.com)



## DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

	No colocar debajo del paciente		Este lado hacia arriba		Indicador de encendido de la alimentación eléctrica
	Este lado hacia abajo		Área de calentamiento		Alarma
	Atención, consultar los documentos anexos		Número de referencia		Número de lote
	Pieza aplicada al paciente de tipo BF según IEC60601-1.		Número de serie		Fecha de fabricación
	Temperatura en el intervalo		Intervalo de temperatura para transporte y almacenamiento		Ajuste de temperatura
	Conservar seco		Intervalo de humedad para transporte y almacenamiento		Fusible
	Equipotencial		Consulte las instrucciones de uso electrónicas en el sitio web en la URL proporcionada		Devolver a representante autorizado
	Sensor de temperatura		No utilizar después de AAAA-MM-DD		Fabricante
	Dispositivo médico		Ver IDU para Advertencias y Precauciones		Dispositivo Médico restringido para la venta o por orden de un médico.
	Representante autorizado en la UE				
	El encerramiento es protegido contra goteo de agua cuando se encuentre inclinado hasta 15°; El goteo vertical no deberá tener efecto dañino cuando la cubierta es inclinada a un ángulo de hasta 15° de su posición normal. (El Controlador)				
	Cumple con la directiva europea sobre productos sanitarios 93/42/CEE				
	Equipamiento médico clasificado por Intertek Testing Services NA Inc. con respecto a choque eléctrico, fuego, y peligros mecánicos únicamente, conforme a UL 60601-1. Clasificado según la directiva sobre productos sanitarios (93/42/CEE) como un producto de Clase IIb.				

## NÚMEROS DE REFERENCIA DE ACCESORIOS

Los siguientes números de referencia de cables se utilizan con el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog:

Número de referencia	Descripción
A101	Cable de mantas de calentamiento Hot Dog, 4 m (13 pies)

## ESPECIFICACIONES

### Características físicas

Dimensiones	29,21 cm altura x 13,97 cm profundidad x 19,69 cm anchura 11,5" altura x 5,5" profundidad x 7,75" anchura
Peso	3,6 kg (8,0 lb)
Montaje	Se puede sujetar en un soporte para suero

### Características de temperatura

Entorno de funcionamiento recomendado	15 °C a 25 °C
Control de temperatura	Microprocesador
Temperaturas de funcionamiento	Temperatura media en la manta de calentamiento:
	Alta      43 ° ± 1,0 °C      109,4 ° ± 1,8 °F
	Media     40 ° ± 1,0 °C      104 ° ± 1,8 °F
	Baja      37 ° ± 1,0 °C      98,6 ° ± 1,8 °F

### Sistema de seguridad

Alarmas de sonido	Mínimo SPL (Nivel de presión de sonido) de 65 dB(A) a 3 m (desde el frente del controlador) con un SPL de fondo que no exceda 55dB(A).
Alarma de sobrecalentamiento primario	Una alarma alta suena a 44 °C + 1 °C
Alarma de sobrecalentamiento secundario	Un circuito electrónico independiente apaga el calentador si la temperatura de la manta de calentamiento alcanza 46°C ± 1°C.
Tiempo para alcanzar la temperatura desde 23°C +/-2°C	Menor a 10 minutos
Temporizador de tiempo agotado	Si el dispositivo de calentamiento no alcanza la temperatura establecida en 10 minutos, el controlador emitirá una alarma.
Monitorización de sobrecarga eléctrica	
- Puerto A	12 amperios máx.
- Puerto B	1,7 amperios máx.
Protección de sobrecarga eléctrica	Líneas con fusible de doble entrada

### Características eléctricas

Corriente de fugas	Cumple los requisitos UL 2601-1 y IEC 60601-1 para equipos de tipo BF de clase I.
Consumo de energía	Pico 580 W

**ESPECIFICACIONES (cont.)**

Cable de alimentación	4,6 m (15 pies) – Puede variar por país y región según los requerimientos y normatividad aplicables.
Valores nominales del dispositivo	Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 600 VA Salida A: 48 VCC, 500 VA máx. Salida B: 48 VCC, 80 VA máx.
Fusibles	T6.3AL250V (2 x 5x20 mm)
Certificaciones	IEC 60601-1; EN 60601-1-2; UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2, No. 601.1, EN 55011



Clasificación	Clasificado según las directrices IEC 60601-1 (y otras versiones nacionales de las directrices) como equipos ordinarios de tipo BF de clase I, operación continua. No es apto su uso en presencia de mezclas de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso. Clasificado por Intertek Testing Services NA Inc. con respecto a choque eléctrico, fuego y peligros mecánicos únicamente, conforme a UL 60601-1. Clasificado según la directiva sobre productos sanitarios (93/42/CEE) como un producto de Clase IIb. Clasificado según la regulación canadiense sobre productos sanitarios como clase II.
Diagnóstico	Un técnico cualificado puede realizar pruebas generales del sistema. El controlador no tiene piezas reparables por el usuario.
Transporte/almacenamiento	Temperatura: -20 °C a 60 °C Humedad: 20% a 80% Conservar seco
Información importante	Este dispositivo cumple con los requisitos EMC conforme a IEC 60601-1-2. No se deben utilizar equipos de transmisión de radio, teléfonos móviles, etc. cerca del dispositivo puesto que eso puede influir en los rendimientos del dispositivo. Debe tenerse especial atención durante el uso de fuentes de emisión fuertes como equipo quirúrgico de alta frecuencia y similares, por ejemplo, los cables AF no deben pasar por el dispositivo ni cerca de él. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un técnico cualificado o con su representante local.

## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)


El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog requiere precauciones especiales en relación con EMC y se debe instalar y poner en servicio conforme a la información de EMC proporcionada en este manual de usuario.

### **Advertencia**

- **El uso de accesorios y cables que no sean los especificados pueden causar un aumento de emisiones o una disminución de inmunidad del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog.**
- **El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog no debe utilizarse junto a otros equipos o apilado con ellos. Si es necesario un uso adyacente o apilado, observar atentamente el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog para verificar que funciona normalmente en esa configuración.**

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas		
El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog™ está diseñado para usarlo en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog debe garantizar que se utiliza en un entorno así.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento normativo	Entorno electromagnético – Guía
Emisiones RF, CISPR 11	Grupo 1	El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog utiliza energía RF solo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones RF, CISPR 11	Clase A	El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog es apto para usarlo en todos los establecimientos excepto los domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a los edificios que se usan con finalidad doméstica.
Emisiones armónicas, IEC 61000-3-2	Clase A	
Emisiones de fluctuaciones y parpadeo de tensión, IEC 61000-3-3	Cumple	

<b>Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética</b>			
El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog™ está diseñado para usarlo en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog debe garantizar que se utiliza en un entorno así.			
<b>Prueba de inmunidad</b>	<b>IEC 60601 Nivel de comprobación</b>	<b>Nivel de cumplimiento normativo</b>	<b>Entorno electromagnético – Guía</b>
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV aire	±6 kV contacto ±8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30%.
Ráfaga/rápidos transitorios eléctricos IEC 61000-4-4	±2 kV para líneas de suministro eléctrico ±1 kV para líneas de entrada/salida	±2 kV para líneas de suministro eléctrico ±1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad del suministro eléctrico debe ser la de un entorno hospitalario o comercial típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1 kV línea(s) a línea(s) ±2 kV línea(s) a tierra	±1 kV línea(s) a línea(s) ±2 kV línea(s) a tierra	La calidad del suministro eléctrico debe ser la de un entorno hospitalario o comercial típico.
Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en líneas de entrada de suministro eléctrico IEC 61000-4-11	<5 % <i>UT</i> (>95 % caída en <i>UT</i> ) para 0,5 ciclos 40 % <i>UT</i> (60 % caída en <i>UT</i> ) para 5 ciclos 70 % <i>UT</i> (30 % caída en <i>UT</i> ) para 25 ciclos <5 % <i>UT</i> (>95 % caída en <i>UT</i> ) para 5 segundos	<5 % <i>UT</i> (>95 % caída en <i>UT</i> ) para 0,5 ciclos 40 % <i>UT</i> (60 % caída en <i>UT</i> ) para 5 ciclos 70 % <i>UT</i> (30 % caída en <i>UT</i> ) para 25 ciclos <5 % <i>UT</i> (>95 % caída en <i>UT</i> ) para 5 segundos	La calidad del suministro eléctrico debe ser la de un entorno hospitalario o comercial típico. Si el usuario del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog requiere funcionamiento continuo durante interrupciones de energía eléctrica, se recomienda que el sistema sea alimentado desde un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.
Campo magnético con la frecuencia de la red eléctrica (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos con frecuencia de la red eléctrica deben encontrarse en los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno hospitalario o comercial típico.
NOTA <i>UT</i> es la tensión de CA de la energía eléctrica antes de la aplicación del nivel de comprobación.			

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética (cont.)			
El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog™ está diseñado para usarlo en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog debe garantizar que se utiliza en un entorno así.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601 Nivel de comprobación	Nivel de cumplimiento normativo	Entorno electromagnético – Guía
RF por conducción IEC 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz	3 V	El equipamiento de comunicaciones RF portátil y móvil no se debe utilizar más cerca de ninguna parte del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog, incluidos cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. <b>Distancia de separación recomendada</b> $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 0,35\sqrt{P}$ De 80 MHz a 800 MHz $d = 0,7\sqrt{P}$ De 800 MHz a 2,5 GHz donde $P$ es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y $d$ es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores RF fijos, según lo determinado por una prospección de sitio electromagnética, <sup>a</sup> debe ser menor que el nivel de cumplimiento normativo en cada gama de frecuencias. <sup>b</sup> Pueden producirse interferencias en las cercanías de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF por radiación IEC 61000-4-3	10 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	10 V/m	
<p>NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama más alta de frecuencias.</p> <p>NOTA 2 Estas directrices pueden no ser de aplicación en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.</p> <p><sup>a</sup> Las intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones base de radio (celular/inalámbrico) teléfonos y radios móviles terrestres, radioaficionados, difusión de radio AM y FM y difusión de TV no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores RF fijos, debe considerarse una prospección de sitio electromagnética. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog supera el nivel de cumplimiento normativo de RF aplicable, se debe observar el sistema para verificar que funciona normalmente. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales como reorientar o reubicar el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog.</p> <p><sup>b</sup> Sobre la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser menores a 3 V/m.</p>			

<b>Distancias de separación recomendadas entre equipamiento de comunicaciones RF portátil y móvil y el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog.</b>			
El sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog™ está diseñado para usarlo en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF por radiación estén controladas. El cliente o el usuario del sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipamiento de comunicaciones RF portátil y móvil (transmisores) y el sistema de calentamiento de pacientes Hot Dog tal y como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipamiento de comunicaciones.			
Potencia nominal de salida máxima del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 0,35\sqrt{P}$	DE 800 MHz a 2,5 GHz $d = 0,7\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,04	0,07
0,1	0,37	0,11	0,22
1	1,2	0,35	0,70
10	3,7	1,1	2,2
100	12	3,5	7,0
Para transmisores con una potencia nominal máxima no enumerada anteriormente, la distancia de separación recomendada $d$ en metros (m) se puede estimar usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde $P$ es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor. NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama más alta de frecuencias. NOTA 2 Estas directrices pueden no ser de aplicación en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.			

Hot Dog es una marca comercial de Augustine Temperature Management, registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de EE. UU. Patentes en trámite.

© 2020 Augustine Temperature Management. Todos los derechos reservados.

P/N 2294ES Revisión G (11/2020)